

Español

**iCare** PATIENT2



iCare PATIENT2  
Manual de instrucciones para iOS

**icare**

## Derechos de autor

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. En caso de conflicto con respecto a un documento traducido, la versión en inglés prevalecerá.

Este dispositivo cumple:

Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios

Este manual de instrucciones es aplicable al software iCare PATIENT2 versión 1.0.x, donde x es una revisión de carácter menor que no afecta a este manual de instrucciones.

Copyright © 2021 Icare Finland Oy. Todos los derechos reservados. Icare es una marca comercial registrada de Icare Finland Oy, todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Fabricado en Finlandia.

Android es una marca comercial registrada o una marca comercial de Google Inc.

Google Play es una marca comercial de Google LLC. App Store es una marca comercial de Apple Inc.

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de dichas marcas por parte de Icare Finland Oy se realiza bajo licencia. Otros nombres de marcas y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



**Icare Finland Oy**

Äyritie 22

01510 Vantaa, Finlandia

Tel. +358 0 9775 1150

**[www.icare-world.com](http://www.icare-world.com), [info@icare-world.com](mailto:info@icare-world.com)**



## Contenido

1. Uso previsto.....	4
2. Avisos de seguridad.....	4
3. Introducción .....	5
4. Requisitos del sistema para iCare PATIENT2.....	6
5. Obtener las credenciales de iCare .....	6
6. Instalación de la aplicación .....	7
7. Conecte su dispositivo móvil al tonómetro mediante Bluetooth® .....	7
7.1. Active Bluetooth en el tonómetro.....	7
7.2. Emparejamiento del tonómetro con su dispositivo móvil .....	7
8. Transferencia de datos de medición.....	8
9. Visualización de los resultados de la medición.....	9
10. Cambio en los ajustes de iCare PATIENT2.....	10
11. Cierre de sesión en iCare PATIENT2.....	10
12. Solución de problemas.....	10
13. Descripción técnica.....	12
14. Símbolos.....	13

## 1. Uso previsto

iCare PATIENT2 (TS05) es una aplicación móvil destinada a transferir datos de mediciones oftálmicas a iCare CLINIC o a un sistema externo. También tiene la capacidad de mostrar datos de mediciones oftálmicas y ayudar en el tratamiento del glaucoma. Está indicada para el uso por parte de profesionales sanitarios y personas legas.


## 2. Avisos de seguridad

- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Asegúrese de que el dispositivo móvil con la aplicación iCare PATIENT2 instalada esté ajustado a la fecha y hora correctas.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Antes de tomar mediciones, actualice manualmente el reloj del tonómetro a su hora local desde los ajustes del tonómetro o automáticamente conectando el tonómetro a la aplicación iCare PATIENT2.
- ⚠ **¡PRECAUCIÓN!** Notifique cualquier incidente grave relacionado con el tonómetro a su autoridad sanitaria competente y al fabricante o al representante del fabricante.

## 3. Introducción

El sistema de software iCare consta de lo siguiente:

- Tonómetro iCare HOME2 para la medición de la presión ocular
- Aplicación móvil iCare PATIENT2 con la que los pacientes y profesionales de la salud pueden ver los datos de medición y transferirlos y almacenarlos en iCare CLINIC o en el servicio iCare CLOUD
- iCare CLINIC, un servicio de software basado en navegador con el que los profesionales de la salud y los pacientes pueden ver los datos de medición

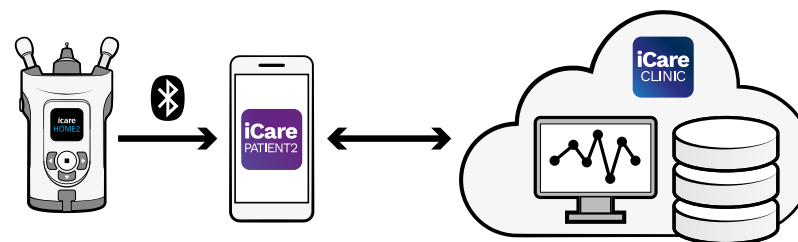

iCare CLOUD se puede utilizar para almacenar los resultados de medición de la presión ocular transferidos desde iCare HOME2 utilizando iCare PATIENT2. Los pacientes pueden almacenar sus datos de medición en una cuenta privada en el servicio iCare CLOUD si su tonómetro no está registrado en la cuenta de iCare CLINIC de un profesional de la salud.

Para ver los resultados de la medición con la aplicación PATIENT2, debe iniciar sesión con las credenciales de iCare. Para obtener información sobre cómo conseguir las credenciales de iCare, consulte el capítulo “5. Obtener las credenciales de iCare”.

Sus credenciales protegen los resultados de sus mediciones frente a otras personas. Si la aplicación le avisa sobre credenciales no válidas, ha introducido una contraseña o dirección de correo electrónico incorrecta, o puede que le hayan robado la contraseña. No comparta su contraseña con ninguna persona más.

Si es un profesional de la salud y desea utilizar iCare PATIENT2 solo para transferir los resultados de la medición de la presión ocular a iCare CLINIC sin usar iCare PATIENT2 para ver los resultados, no es necesario que inicie sesión en la aplicación.

Para obtener más información sobre cómo hacer funcionar el dispositivo HOME2, consulte el manual de instrucciones de iCare HOME2.

## 4. Requisitos del sistema para iCare PATIENT2

- iPhone
- Sistema operativo iOS 12 o posterior
- Conexión a Internet

Para asegurarse de que la aplicación iCare PATIENT2 funciona correctamente, instale siempre las últimas actualizaciones de software disponibles para su dispositivo móvil y la aplicación iCare PATIENT2.

## 5. Obtener las credenciales de iCare

Para ver los resultados de medición con la aplicación iCare PATIENT2, debe iniciar sesión con las credenciales de iCare. Si su tonómetro iCare HOME2 está registrado en la cuenta CLINIC de una clínica u hospital, póngase en contacto con la clínica u hospital para obtener las credenciales.

**Nota para los profesionales de la salud:** Las credenciales del paciente pueden crearse en iCare CLINIC bajo la pestaña Perfil del paciente de la sección Cuenta de usuario proporcionando la dirección de correo electrónico del paciente. El paciente recibirá un correo electrónico de invitación que incluye un enlace para crear una contraseña.

Si su tonómetro no está registrado en la cuenta CLINIC de ninguna clínica u hospital, debe registrar su tonómetro en iCare CLOUD para poder utilizar la aplicación iCare PATIENT2. Consulte la guía “Primeros pasos” suministrada junto con el tonómetro iCare HOME2 para obtener instrucciones sobre cómo registrar su tonómetro. Obtendrá sus credenciales de iCare en el proceso de registro.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su profesional de la salud, el distribuidor del tonómetro o iCare.

**Nota:** las credenciales de usuario profesional (médico, formador o administrador) de iCare CLINIC no se pueden usar para iniciar sesión en la aplicación PATIENT2. La aplicación PATIENT2 solo se utiliza para revisar los resultados de un paciente individual utilizando las credenciales de CLINIC de un paciente individual y para cargar datos de medición desde iCare HOME2(s) a iCare CLINIC, en cuyo caso no se necesita iniciar sesión en PATIENT2.

## 6. Instalación de la aplicación








1. Abra la App Store en su dispositivo móvil.
2. Busque iCare PATIENT2.
3. Siga las instrucciones de instalación que se muestran en la pantalla.

## 7. Conecte su dispositivo móvil al tonómetro mediante Bluetooth®

### 7.1. Active Bluetooth en el tonómetro

**Nota:** La aplicación iCare PATIENT2 solo es compatible con el tonómetro iCare HOME2.

Es posible que Bluetooth ya esté habilitado en el tonómetro. Puede comprobar el estado de Bluetooth de su tonómetro y activar Bluetooth si es necesario siguiendo estas instrucciones.

1. Pulse  hasta que oiga un pitido para encender el tonómetro.
2. Pulse  hasta que vea **AJUSTES** en la pantalla del tonómetro, y pulse .
3. Pulse  hasta que vea **BLUETOOTH**, y pulse .
4. Si Bluetooth está desactivado, pulse  hasta que vea **ENCENDER**, y pulse .

### 7.2. Emparejamiento del tonómetro con su dispositivo móvil

1. Vaya a los ajustes de su dispositivo móvil y active Bluetooth.
2. Abra la aplicación iCare PATIENT2 y pulse **COMIENCE A UTILIZAR LA APLICACIÓN**.
3. Seleccione su área de residencia y la opción correcta acerca de dónde se almacenarán sus datos de presión ocular.
4. Lea los términos de servicio y acepte los términos de uso y el tratamiento de sus datos personales marcando las casillas correspondientes.
5. Pulse **CONTINUAR**.
6. Presione **BUSCAR DISPOSITIVOS**. Si la aplicación solicita permiso para utilizar Bluetooth, pulse **OK** (aceptar).

7. Seleccione el tonómetro correcto de la lista de tonómetros iCare HOME2 encontrados. Asegúrese de que el número de serie del tonómetro que aparece en la pantalla del dispositivo móvil coincida con el de la parte posterior del tonómetro. El número de serie del tonómetro aparece marcado con SN.



8. Seleccione **EMPAREJAR TONÓMETRO**.
9. En la solicitud de emparejamiento Bluetooth, introduzca el código PIN que aparece en la pantalla del tonómetro y pulse **Emparejar**.
10. Cuando el tonómetro se haya emparejado correctamente con su dispositivo móvil, pulse **CONTINUAR** en la pantalla de PATIENT2.

Ahora puede pulsar **SINCRONIZAR** para transferir los resultados de medición del tonómetro a su dispositivo móvil, o iniciar sesión en la aplicación iCare PATIENT2 para ver los resultados de mediciones anteriores.

## 8. Transferencia de datos de medición

1. Encienda el tonómetro.
2. En su dispositivo móvil, abra la aplicación iCare PATIENT2.
3. Pulse **SINCRONIZAR** para transferir sus mediciones del tonómetro a su dispositivo móvil.


La transferencia de los resultados de medición puede tardar hasta un par de minutos dependiendo de la conexión de red. Verá el mensaje “[número de] mediciones transferidas” o el mensaje “no hay nuevas mediciones” una vez completada la transferencia de datos.

Los resultados de la medición permanecen en el tonómetro iCare HOME2 después de la transferencia de los datos de medición.

## 9. Visualización de los resultados de la medición

1. Abra la aplicación iCare PATIENT2 en su dispositivo móvil.
2. Si todavía no ha iniciado sesión, pulse **INICIAR SESIÓN** e introduzca sus credenciales de iCare. Consulte el capítulo “5. Obtener las credenciales de iCare” para obtener información sobre cómo conseguir las credenciales de iCare.
3. Pulse **MEDICIONES**.

El gráfico azul muestra las mediciones del ojo derecho y el gráfico naranja las medidas del ojo izquierdo.



- 1: Medición seleccionada en el gráfico
- 2: El resultado de la medición seleccionada en mmHg
- 3: Fecha y hora de la medición
- 4: Pulse para abrir la medición anterior o siguiente

Para desplazarse por el gráfico, deslice el dedo por la pantalla.

Para acercarse y alejarse del gráfico, pellizque la pantalla táctil con dos dedos y deslícelos horizontalmente separándolos o juntándolos.

Para ver el resultado de cada medición, toque los puntos del gráfico o utilice el menú de píldoras de la parte superior de la pantalla para seleccionar la medida que desee.

Si una medición está marcada con , la medición está fuera de la escala seleccionada. Pulse  para ver el resultado de la medición.

## 10. Cambio en los ajustes de iCare PATIENT2


En la vista Home, pulse  > **Ajustes**.

Para definir qué valores se muestran en el gráfico, pulse **Valor máximo en el gráfico** o **Valor mínimo en el gráfico**, y seleccione el nuevo valor.

Si desea utilizar otro tonómetro con la aplicación, pulse **Cambio de tonómetro**. Automáticamente se cerrará la sesión desde la aplicación. Para transferir los datos de mediciones desde otro tonómetro, debe emparejarlo con su dispositivo móvil.

## 11. Cierre de sesión en iCare PATIENT2

En el uso diario, no es necesario cerrar sesión desde la aplicación. No obstante, si deja su teléfono a otra persona, cierre sesión desde la aplicación para evitar que pueda ver los resultados de sus mediciones.

En la vista Home, pulse  > **Ajustes** > **Cerrar sesión**.

A pesar de haber cerrado sesión, aún podrá transferir las mediciones desde el tonómetro **a iCare CLINIC o iCare CLOUD**, pero no podrá verlas en su dispositivo móvil.

Si ya no necesita utilizar la aplicación iCare PATIENT2, puede desinstalarla. La desinstalación de la aplicación no eliminará los datos de mediciones de la presión ocular de iCare CLINIC o iCare CLOUD.

## 12. Solución de problemas

**Consejo:** Para obtener información de contacto, como las direcciones de correo electrónico de iCare, pulse  > **Información**.

- **Si recibe el mensaje de error No se ha podido buscar dispositivos**, encienda la conexión Bluetooth en su dispositivo móvil. Conceda a iCare PATIENT2 el permiso para utilizar Bluetooth en su dispositivo móvil: vaya a **Settings** (Ajustes) de su dispositivo móvil > **iCare PATIENT2** y active Bluetooth.
- **Si recibe el mensaje de error Error durante el emparejamiento**, vuelva a emparejar el tonómetro con el dispositivo móvil y asegúrese de introducir el código PIN correcto en la solicitud de emparejamiento Bluetooth. Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a una red. Asegúrese de que el tonómetro esté encendido y de que la conexión Bluetooth esté activada tanto en el tonómetro como en el dispositivo móvil. Asegúrese de que el uso de Bluetooth esté permitido en su dispositivo móvil.
- **Si ha transferido sus mediciones desde el tonómetro, pero no puede verlas en los resultados de medición**, asegúrese de que el tonómetro esté registrado a su nombre. Póngase en contacto con su profesional de la salud, el distribuidor del tonómetro o iCare. Compruebe también que el reloj del tonómetro muestre la hora correcta. Si no es así, transfiera los datos de mediciones una vez desde el tonómetro a su dispositivo móvil. El reloj del tonómetro se actualiza durante la transferencia.
- **Si recibe el mensaje de error Error durante la transferencia**, asegúrese de que el dispositivo móvil esté conectado a una red. Asegúrese de que el tonómetro esté encendido y de que la conexión Bluetooth esté activada tanto en el tonómetro como en el dispositivo móvil. Asegúrese de haber concedido a iCare PATIENT2 el permiso para utilizar Bluetooth en su dispositivo móvil: vaya a **Settings** (Ajustes) de su dispositivo móvil > **iCare PATIENT2** y active Bluetooth.
- **Si recibe el mensaje de error Error de conexión al servidor. No se pueden cargar mediciones**, asegúrese de que el dispositivo móvil esté conectado a una red. Cierre la vista de mediciones y vuelva a abrirla. También recibirá este mensaje de error si ha iniciado sesión en la aplicación iCare PATIENT2 con credenciales de profesional de la salud de CLINIC en lugar de credenciales de paciente.
- **Si recibe el mensaje de error El usuario no está autorizado. No se pueden cargar mediciones**, su sesión de conexión ha caducado. Vuelva a iniciar sesión.

- **Si recibe el mensaje de error Dispositivo no registrado**, debe registrar el tonómetro. Consulte el capítulo “5. Obtener las credenciales de iCare” para obtener información sobre cómo registrar su tonómetro.
- **Si recibe el mensaje de error Error de inicio de sesión debido a un error inesperado**, intente volver a iniciar sesión en la aplicación iCare PATIENT2. Asegúrese de que el dispositivo móvil esté conectado a una red. Si el problema persiste, póngase en contacto con su profesional de la salud, el distribuidor del tonómetro o iCare.
- **Si recibe el mensaje de error Credenciales no válidas**, intente volver a iniciar sesión en la aplicación iCare PATIENT2. Asegúrese de que su dirección de correo electrónico y contraseña sean correctas. Si el problema persiste, póngase en contacto con su profesional de la salud, el distribuidor del tonómetro o iCare.
- **Si necesita ayuda con la aplicación iCare PATIENT2**, póngase en contacto con su profesional de la salud, el distribuidor del tonómetro o iCare.
- **Si la aplicación iCare PATIENT2 no funciona correctamente o detecta errores en este manual de instrucciones**, póngase en contacto con [info@icare-world.com](mailto:info@icare-world.com), o si se encuentra en los EE. UU., póngase en contacto con [infoUSA@icare-world.com](mailto:infoUSA@icare-world.com).

## 13. Descripción técnica

Cuando el tonómetro iCare HOME2 está conectado a un dispositivo móvil con una conexión Bluetooth, la aplicación iCare HOME2 lee los resultados de la medición de la presión ocular del tonómetro y los transfiere y almacena en la base de datos iCare CLINIC en Internet utilizando la conexión de datos del dispositivo móvil. La aplicación también utiliza la conexión de datos para leer los resultados de la medición de la base de datos, ya que los resultados se almacenan solo en la base de datos, no en el dispositivo móvil.





No conecte el dispositivo móvil con la aplicación iCare PATIENT2 instalada a la red de TI de un profesional de la salud a la que estén conectados el software o los dispositivos médicos del profesional de la salud.

El dispositivo móvil con la aplicación iCare PATIENT2 instalada puede utilizar cualquier conexión a Internet que permita la comunicación HTTPS.

Si se produce un error en la conexión de datos, los resultados de la medición no se pueden transferir desde el tonómetro iCare HOME2 a la base de datos iCare CLINIC y los resultados de la medición no se pueden visualizar.

Los resultados de la medición de la presión ocular se muestran en milímetros de mercurio (mmHg) con la precisión de un milímetro de mercurio. La escala disponible del eje y es de 5 mmHg a 50 mmHg.

## 14. Símbolos

	Fabricante
	Cuidado
<b>Solo con receta (Estados Unidos)</b>	La legislación federal (de los EE.UU.) solo permite la venta de este dispositivo por parte de o por prescripción facultativa de un médico o un profesional debidamente autorizado.
	Marca CE
	El producto es un dispositivo médico



### Icare Finland Oy

Äyritie 22  
01510 Vantaa, Finlandia  
Tel. +358 0 9775 1150  
info@icare-world.com

### Icare USA, Inc.

4700 Falls of Neuse Rd. Ste 245  
Raleigh, NC. 27609  
Tel. +1 888.422.7313  
Fax +1 877.477.5485  
infoUSA@icare-world.com

[www.icare-world.com](http://www.icare-world.com)

# icare

Icare es una marca comercial registrada de Icare Finland Oy, Centervue S.p.A., Icare Finland Oy e Icare USA Inc. son parte del Grupo Revenio y representan la marca Icare. No todos los productos, servicios u ofertas a los que se hace referencia en este folleto disponen de aprobación o están disponibles en todos los mercados, y el etiquetado y las instrucciones aprobados pueden variar de un país a otro. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios en el diseño y el alcance de la entrega y como resultado de los avances técnicos en curso.